



MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI SALVIA

nejpřesnější určování postupu detoxikace

**Nejprve si musíme uvědomit,
že pracujeme s klientem,
který má své představy o zdraví,
a proto je důležité mu vysvětlit postup,
který budeme provádět.**

**Tím navodíme příjemnou atmosféru a
odstraníme bariéry strachu či nedůvěry.**

**Proto je velice důležité znát přístroj
Salvia a umět odpovídat
na všetečné otázky klientů.**

Přístroj SALVIA



Základní popis

bateriově napájený přístroj pracující dle metody německého lékaře R.Volla (50. léta), EAV – hodnocení akupunkturálních drah v těle

- s úpravou dr. Schimmela – použití jednoho bodu k získání všech informací
- možno zjišťovat, který lék a které prostředky jsou pro konkrétního člověka a choroby dobré, ale dokonce i to, co se v organismu nachází, a to pomocí tzv. testovacích ampulí

Základní popis

měření kožního odporu z jediného bodu na dlani na podkladě vegetativního funkčního testu

- Sledování rovnováhy sympatiku a parasympatiku (autonomní nervový systém)
- Systémy jsou v dynamické rovnováze, testovaný materiál evokuje dočasnou aktivaci sympatiku, kterou měříme a po krátké době dochází ke opět ke zklidnění

vegetativní funkční test reaguje na interakci testovaného materiálu a měřenou osobu

Vegetativní fčn. test

Děje, které neovlivňujeme vůlí – zvlhnutí rukou, rychlost tepu a dechu, změny tlaku, zornic

Detektor lži = psychogalvanická reakce – biometrické sledování vodivosti kůže – měření stresu a emoční zátěže

Není u soudu brán jako důkaz- zločinci dokáží změny veg. fčí natrénovat

Ovlivňují nemoci – poruchy veg. Systému, schizofrenie, neurotici a jiné duševní nemoci, deprese, fobie, vliv drog

Základní popis

Lze testovat jakékoliv biologické látky,
potraviny, alopatické či homeopatické léky,
potravní doplňky, alergenů, léčivé rostliny

Lze testovat i informace v holografickém
zápisu

- Ampule s informacemi
- Pojmy z programu EAM tester
- Informační preparáty

Funkce přístroje

**Orientačně srovnávací test
při vložení testovacího materiálu
do zabudované misky**




Popis ovládacích prvků

1. **POVER** (žlutá kontrolka) indikuje stav napájecích článků. Jakmile bliká slabě nebo zhasne, je třeba články vyměnit!
2. **GAIN** (vnější větší točítka) slouží k přizpůsobení citlivosti přístroje povrchovému odporu kůže. Odpor kůže je závislý na její vlhkosti:
 - šipka knoflíku na hodnotě 1 ukazuje citlivost nejmenší
 - šipka knoflíku na hodnotě 9 ukazuje citlivost největší
3. **VOLUME** (vnitřní menší točítka)
Regulátor hlasitosti akustického signálu, jehož výška je závislá na hodnotě indikované panelovým měřicím přístrojem
4. **INDIKÁTOR** (panelový měřicí přístroj)
Stupnice 0 -100 má vypovídající hodnotu pouze orientační, nemá pro měření žádný význam



Příslušenství přístroje

- postříbřená válcová elektroda s černým vodičem s zapojuje do černé zdířky v boku přístroje
- sonda s postříbřeným semisférickým hrotem s červeným vodičem se zapojuje do červené zdířky v boku přístroje

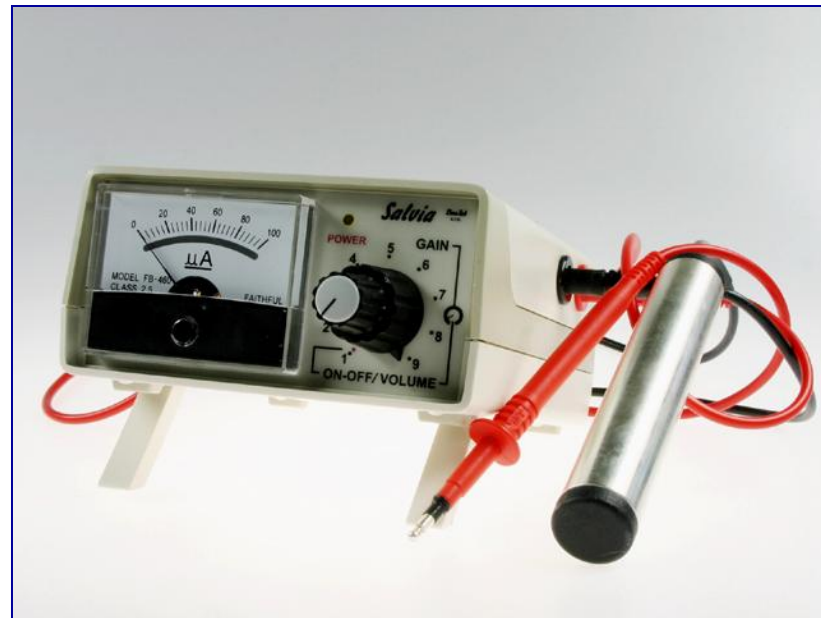


Kontrola přístroje před měřením

- a) v klidovém stavu zkontrolujeme nulovou výchylku měřidla a v případě odchylky od nuly korigujeme otáčením černého šroubu v dolní části měřidla
- b) zapneme přístroj
- c) výchylka měřidla se nesmí při odpojené sondě a elektrodě vychýlit z nulové hodnoty
- d) zapojíme elektrodu a sondu do přístroje, točítkem GAIN nastavíme hodnotu mezi 1 – 3 a sondu s elektrodou zkratujeme a kontrolujeme, jestli měřidlo dosáhlo výchylky 100

KONTROLU PROVÁDÍME
PŘED KAŽDÝM MĚŘENÍM

Průběh testování

1. Klient zbaví obě ruce šperků, hodinek, řetízků, ruce bude mít čisté. **Při velké vodivosti usuzujeme na potivost a doporučíme umytí.**
2. Klient sedí proti terapeutovi, v jedné ruce drží sondu a druhou má položenou na podložce, otočenou dlaní nahoru.

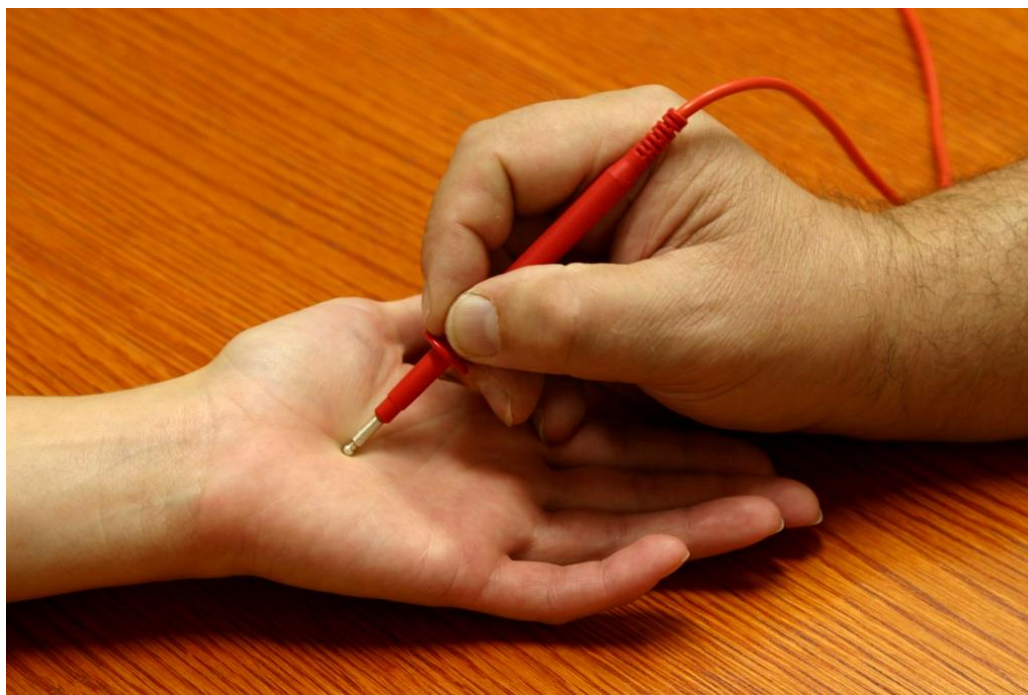


Průběh testování


3. Terapeut vybere jeden z doporučených testovacích bodů na dlani a naučeným přitlakem (sklon sondy ca. 45 st. od vodorovné plochy) **provádí pumpování na vybraném bodu a dosahuje výchylky měřidla na hodnotu 80** (použít větší točítka pro určení vodivosti kůže).
4. Při opakujícím se stejném přitlaku, kdy udržujeme stálý lehký kontakt s kůží a měřidlo se stále vrací na stejnou hodnotu 80, **provedeme test správnosti nalezeného bodu**, a to vložением testovacího vzorku červené barvy.
5. Jestliže klient na vložení tohoto vzorku do zabudované misky zareaguje pozitivně, tzn. měřidlo se vychýlí na hodnotu 60, **našli jsme ten správný bod** a můžeme se pustit do měření.

DIALOG S PŘÍSTROJEM

- **Prázdná**
zabudovaná miska
= 80


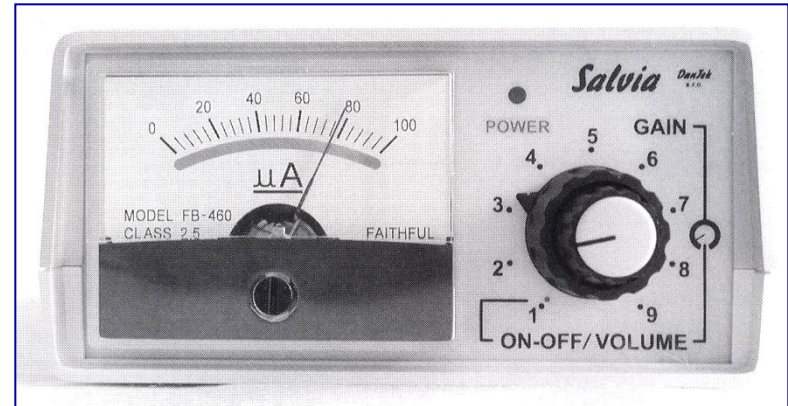


- **Červená**
testovací ampulka
= 60

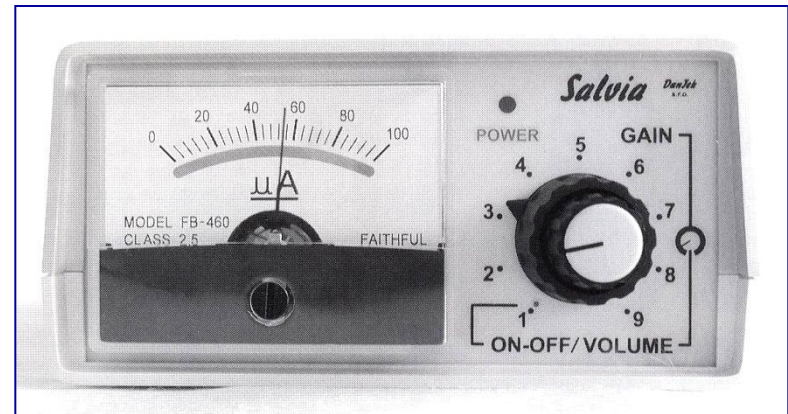



Příklad měření

1. Vložíme-li do misky testovací ampulku „játra“ a měřidlo se vychýlí k hodnotě 60, můžeme předpokládat, že játra vykazují toxické zatížení.

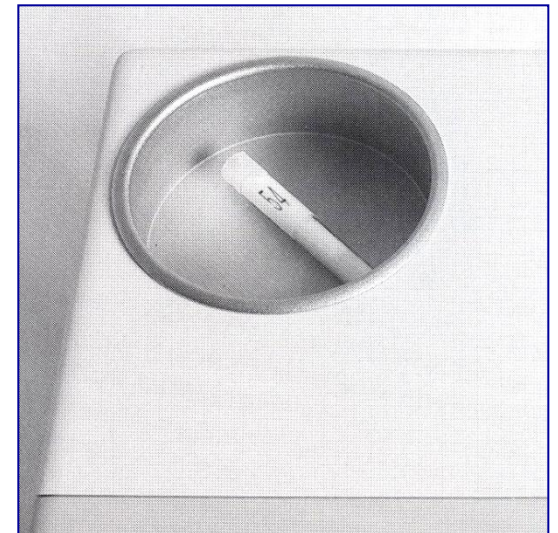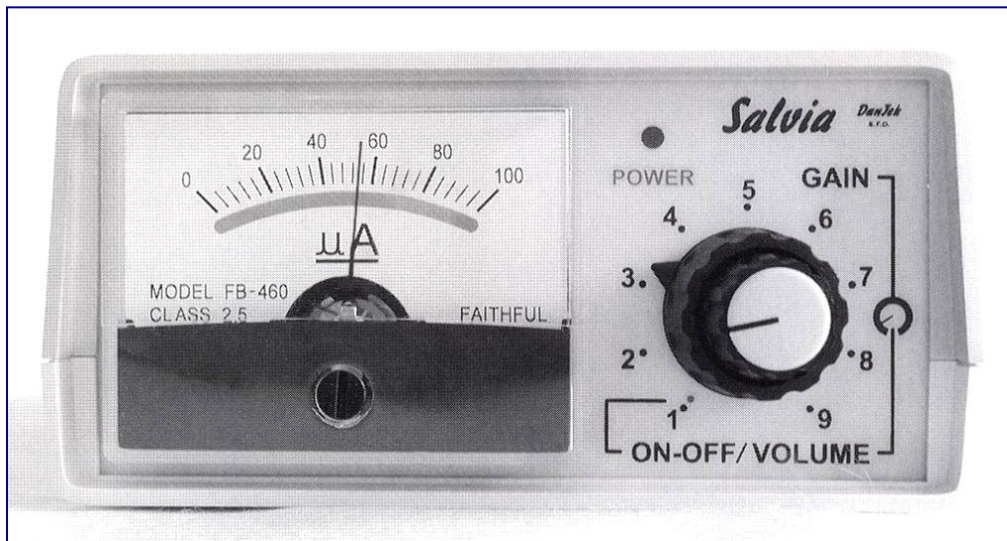


Příklad měření

2. Jestliže pak k ampulce „játra“ přidáme do misky další ampulku (např. „viry“) a měřidlo se vychýlí k hodnotě 80, znamená to, že játra jsou napadena viry.

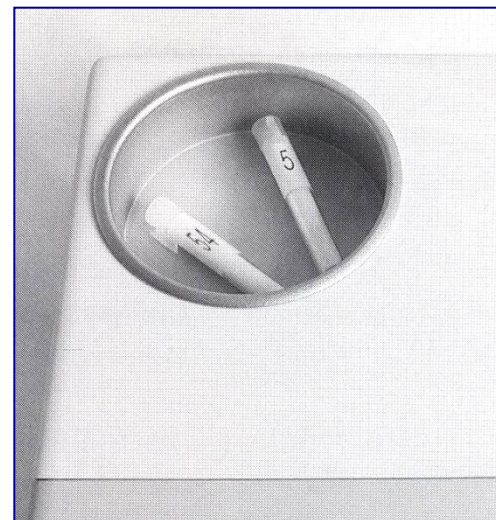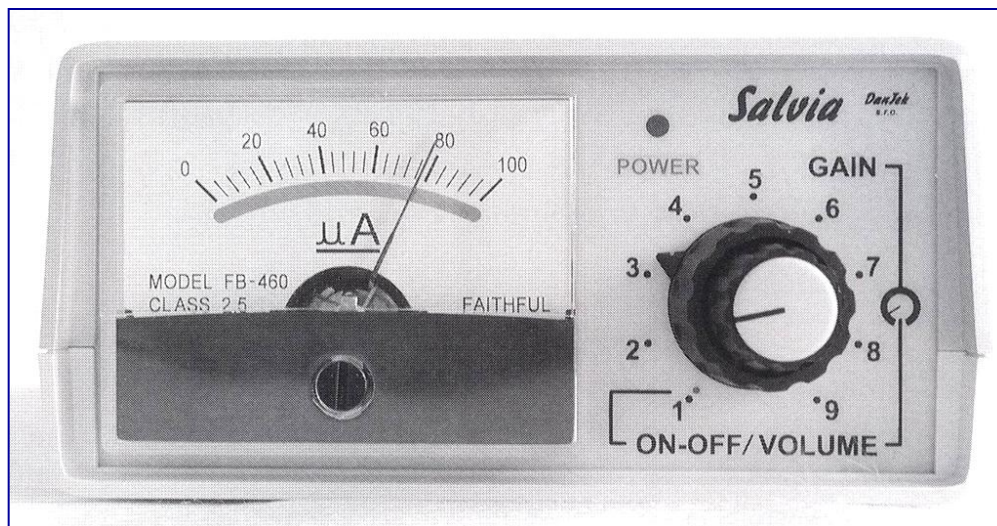


Příklad měření

3. Jestliže však při vložení ampulky „viry“ zůstává hodnota stále na 60, znamená to, že viry nejsou obsahem jater.
4. Přidáme-li k těmto dvěma ampulkám játra + viry = 80, preparát Antivir a měřidlo se vychýlí na hodnotu 60, máme jistotu, že tento preparát dokáže na testovaném orgánu rozpoznat tyto toxické zátěže

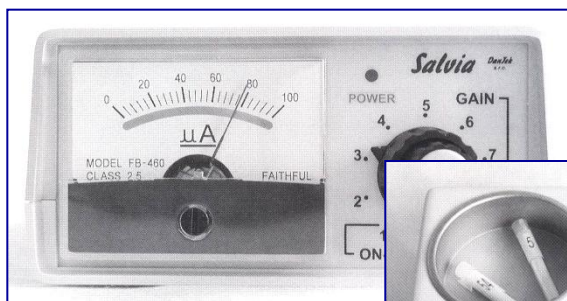


+



+



=

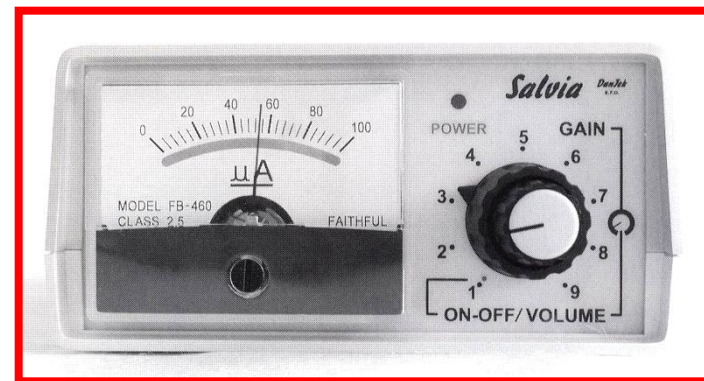

Měření pomocí sad

Základní sada - obecné příčiny nemocí a základní zátěže – mikrobiologie, metabolity, poruchy imunity, základní toxiny životního prostředí...

Orgánová sada – 64 orgánů v lidském těle

Emocionální sada – 64 obvyklých emocí, které mohou být příčinou problémů

Sada strachy – strachy, které negativně ovlivňují tělo

Měření pomocí sad

Potravinová sada – různé druhy potravin, lze použít pro měření alergií, metabolických poruch a snášenlivosti a vhodnosti potravin pro daného člověka

Preparátová sada – vzorky základních preparátů

Sada na měření infekčních ložisek v orgánech